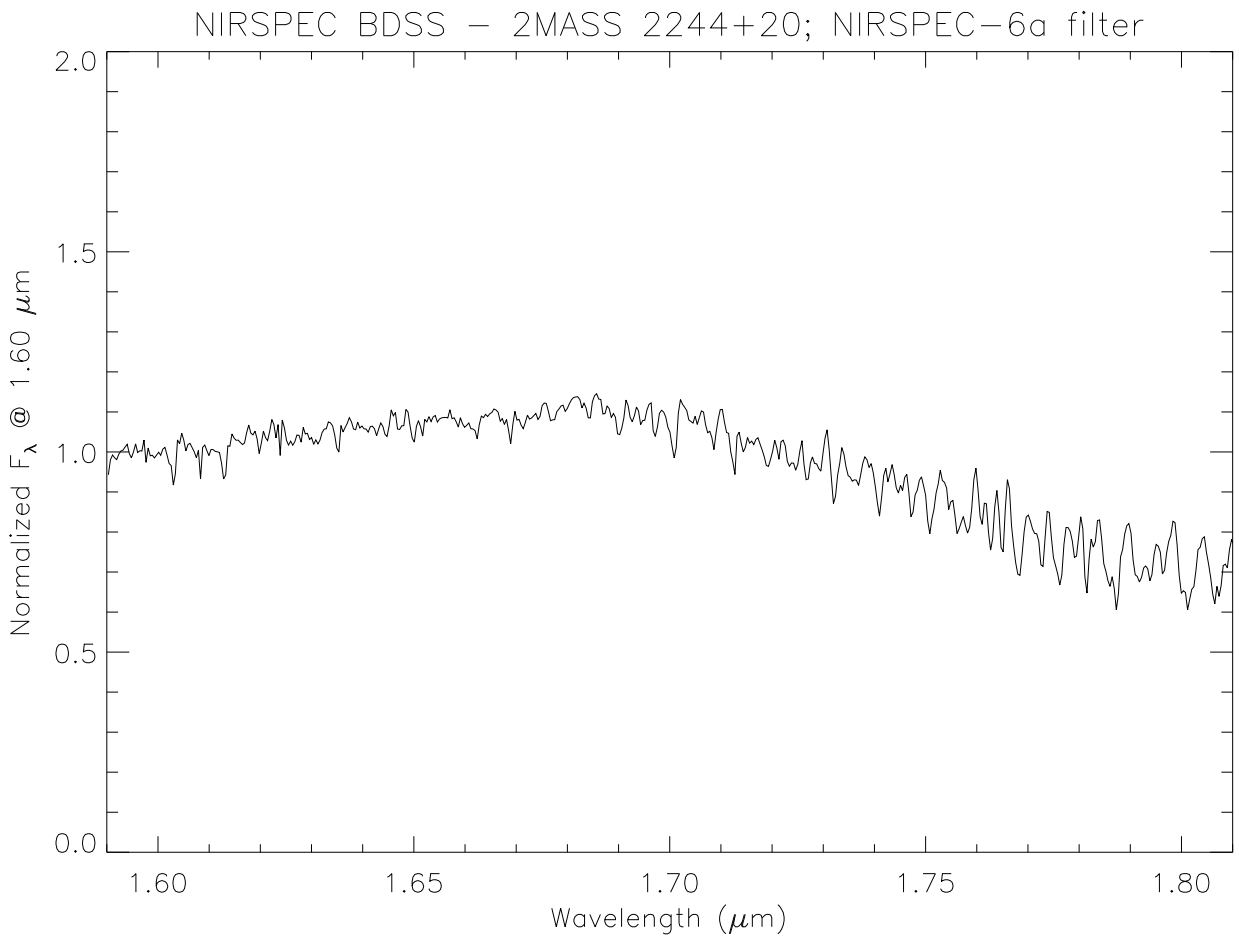
NIRSPEC BDSS – 2MASS 2244+20; NIRSPEC–6a filter
Normalized F_λ @ 1.60 μm
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
Wavelength (μm)